
GGD
Amsterdam

Analyse incidentenlog 24 tot 30 mei

Overzicht aantal cliënten

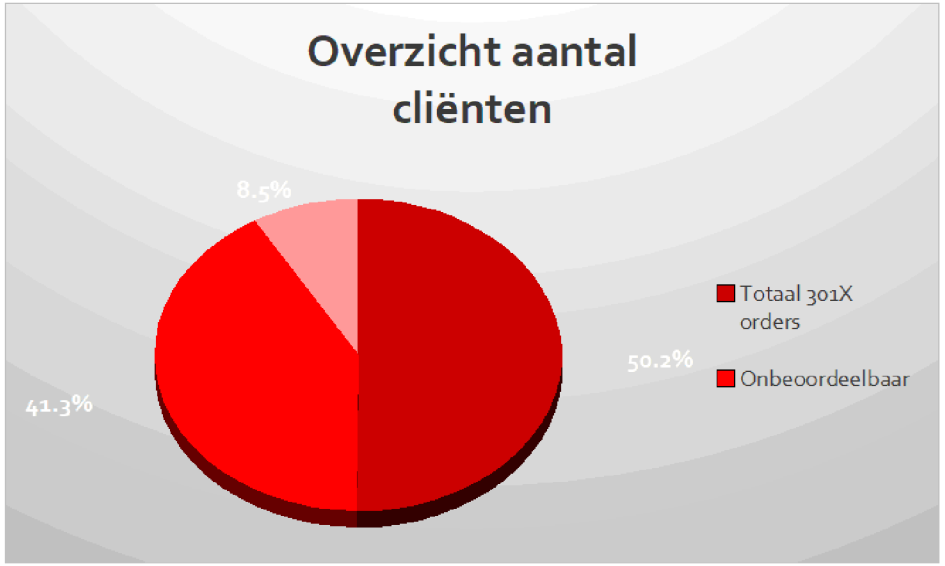


Totaal 301X orders	482
Onbeoordeelbaar	397
Negatief	82
Onbekend	3

Overzicht aantal meldingen

Totaal aantal meldingen in incidentenlog	105
Meldingen - platform	24
Meldingen - afnemer	16
Analyse mislukt - onbekend	10
Analyse mislukt - uitvoering en/of platform	16
Negatieve metingen afgekeurd	39
Afgekeurde negatieve metingen herleidbaar tot afnemer	28
Afgekeurde metingen m.b.t criteria interpretatie	11


Meldingen over afnemer en/of platform

Bij meldingen met platform zijn er soortgelijke meldingen als vorige week binnen gekomen. Denk hierbij aan metingen die niet stoppen, BreathBase platform die plots wegvalt en onstabiele omgevingsmetingen. Bij meldingen herleidbaar tot afnemer hebben de Key Users voornamelijk feedback aan de afnemers gegeven over klik en/of invoer fouten, onjuist interpreteren meting en incidenteel dat de koppelstuk van de SpiroNose viel. Er waren opmerkelijk veel meldingen over systeemfouten.

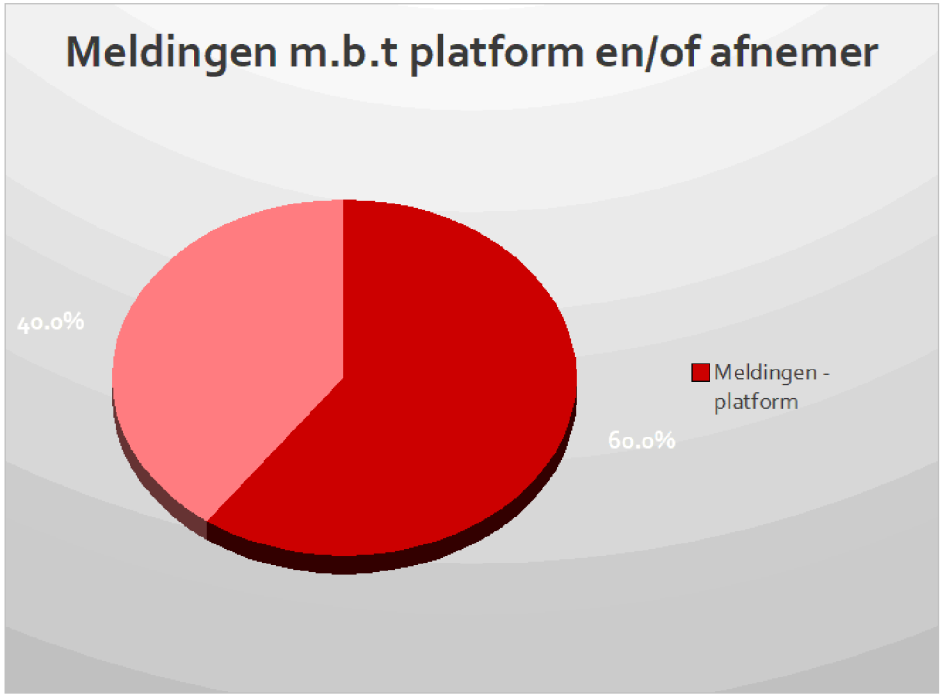

Categorie	Totaal
Meldingen m.b.t platform	24
Meldingen herleidbaar tot afnemer	16

Meldingen m.b.t status “Analyse mislukt”

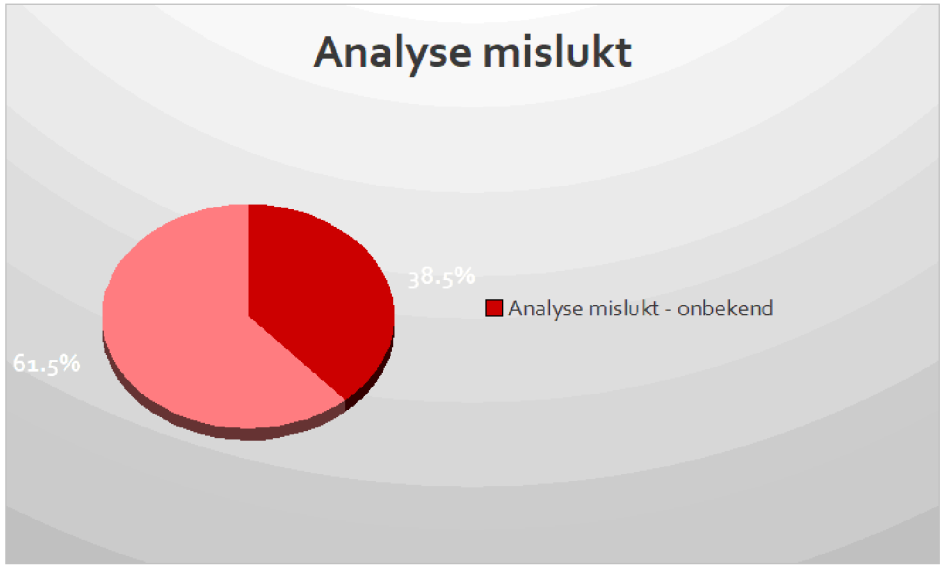


Categorie	Totaal
Analyse mislukt - onbekend	10
Analyse mislukt – uitvoering en/of platform	16


De meldingen van Analyse Mislukt heb ik onderverdeeld in meldingen waarbij de oorzaak voor een analyse mislukt onbekend is en meldingen waarbij de Key User de oorzaak kunnen inschatten. Oorzaken m.b.t. Analyse mislukt zijn inschattingen op basis van observatie en interpretatie. De daadwerkelijke oorzaken dient Breathomix nader te bepalen. 26 Analyses mislukt betekent dat er 26 cliënten door zijn gestuurd naar de PCR. Meldingen waarbij extra coaching aan de afnemers voldoende is daar gaan de Key Users verbetering in brengen. De aandachtspunten voor de afnemer hierbij waren voornamelijk meer coaching aan de cliënt tijdens breath hold en de langzame en maximale ademhaling.

Negatieve metingen afgekeurd door de Key User

In de grafiek is af te lezen dat 72% van de negatieve metingen afgekeurd wordt door een Key User omdat de afnemer extra coaching nodig heeft Dit is een zorgwekkende trend. Ik een onderscheid gemaakt tussen incidenten die herleidbaar zijn tot de afnemer en metingen die alleen op basis van de gestelde richtlijnen (vanuit Breathomix) zijn afgekeurd. Denk hierbij aan stijging en/of daling van de rode of blauwe lijn.

In de incidentenlog is te achterhalen dat de negatieve metingen voornamelijk werden afgekeurd vanwege niet behalen criteria voor de langzame, maximale ademhaling, te korte breath hold en daling en/of stijging van de rode lijn. De Key User hebben naar aanleiding van feedback van de kwaliteitsfunctionaris doelgericht extra coaching gegeven aan bepaalde afnemers en ook veel fysieke afnames meegekeken voor extra feedback.

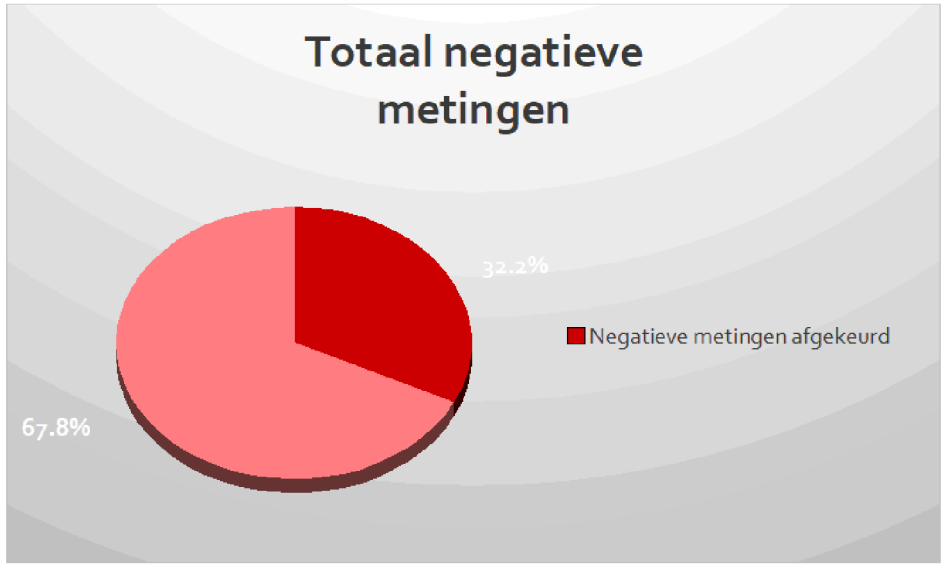

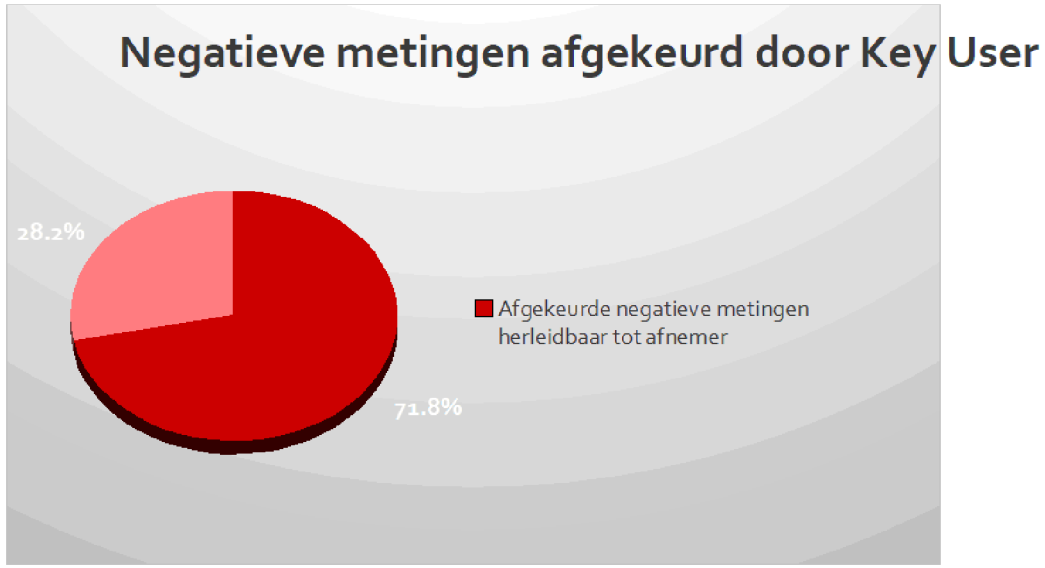

Categorie	Totaal
Afgekeurde negatieve metingen herleidbaar tot afnemer	28
Afgekeurde metingen m.b.t criteria interpretatie	11

Overzicht 8 tot 30 mei

