Analyse Spironose ademtesten
Venray, Buikslotermeerplein, Apeldoorn

Cumulatieve rapportage platte data

Op basis van gegevens:

Venray, Buikslotermeerplein	09/06/2021 – 24/06/2021
Apeldoorn	10/06/2021 – 24/06/2021

Weekrapportage

BP2
Gd3
BTv3
BTv4

Totaaloverzicht uitslagen

9/06/2021 – 24/06/2021

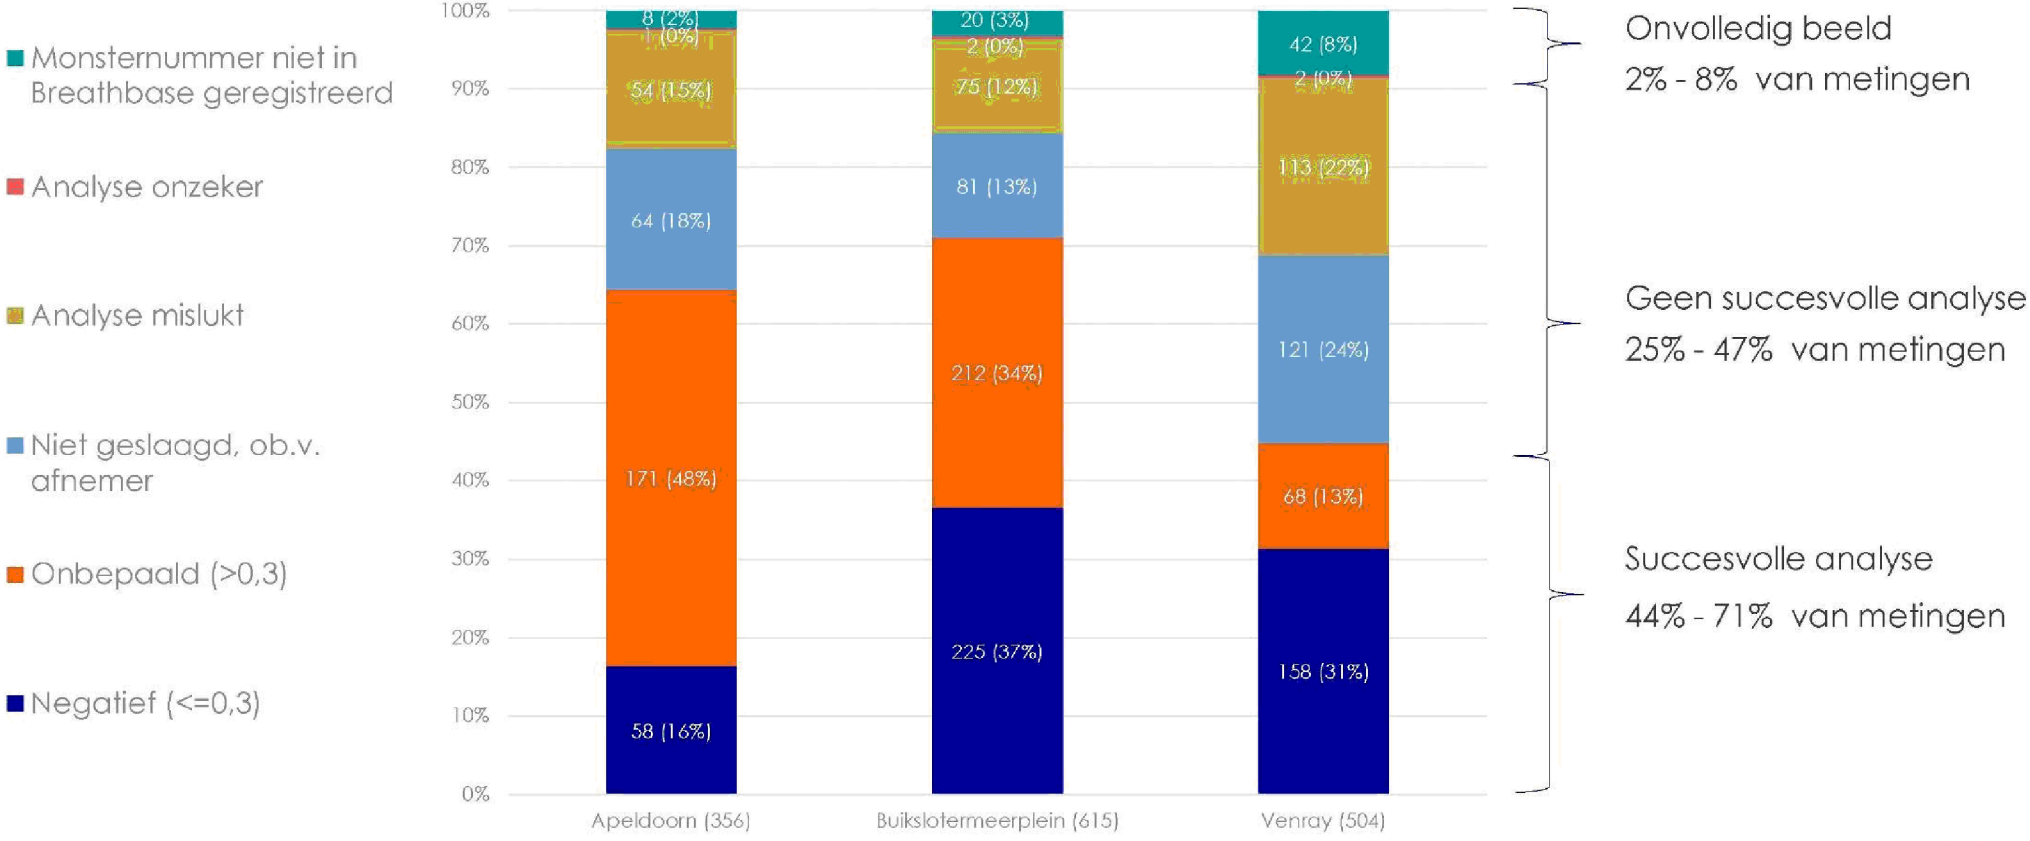

* De barcode van de client is niet gescand in de Breathbase applicatie (registratiefout).

Dia 2

BP2 aantallen komen niet overeen met de slides 4, 5 en 6 per locatie. Zowel niet qua totalen als qua afzonderlijke getallen?
5.1.2e 5.1.2e 24-6-2021

Gd3 Gezien de opmerking van 5.1.2e heb ik het niet ook nagerekend, dat kan ik doen als je de cijfers hebt aangepast.
5.1.2e 5.1.2e de; 25-6-2021

BTv3 Cijfers op andere pagina's klopten inderdaad niet (er miste nog twee dagen), nu wel!
5.1.2e 5.1.2e van; 25-6-2021

BTv4 [@5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e zou jij nog een check willen doen?
5.1.2e 5.1.2e van; 25-6-2021

Totaaloverzicht uitslagen

9/06/2021 – 24/06/2021

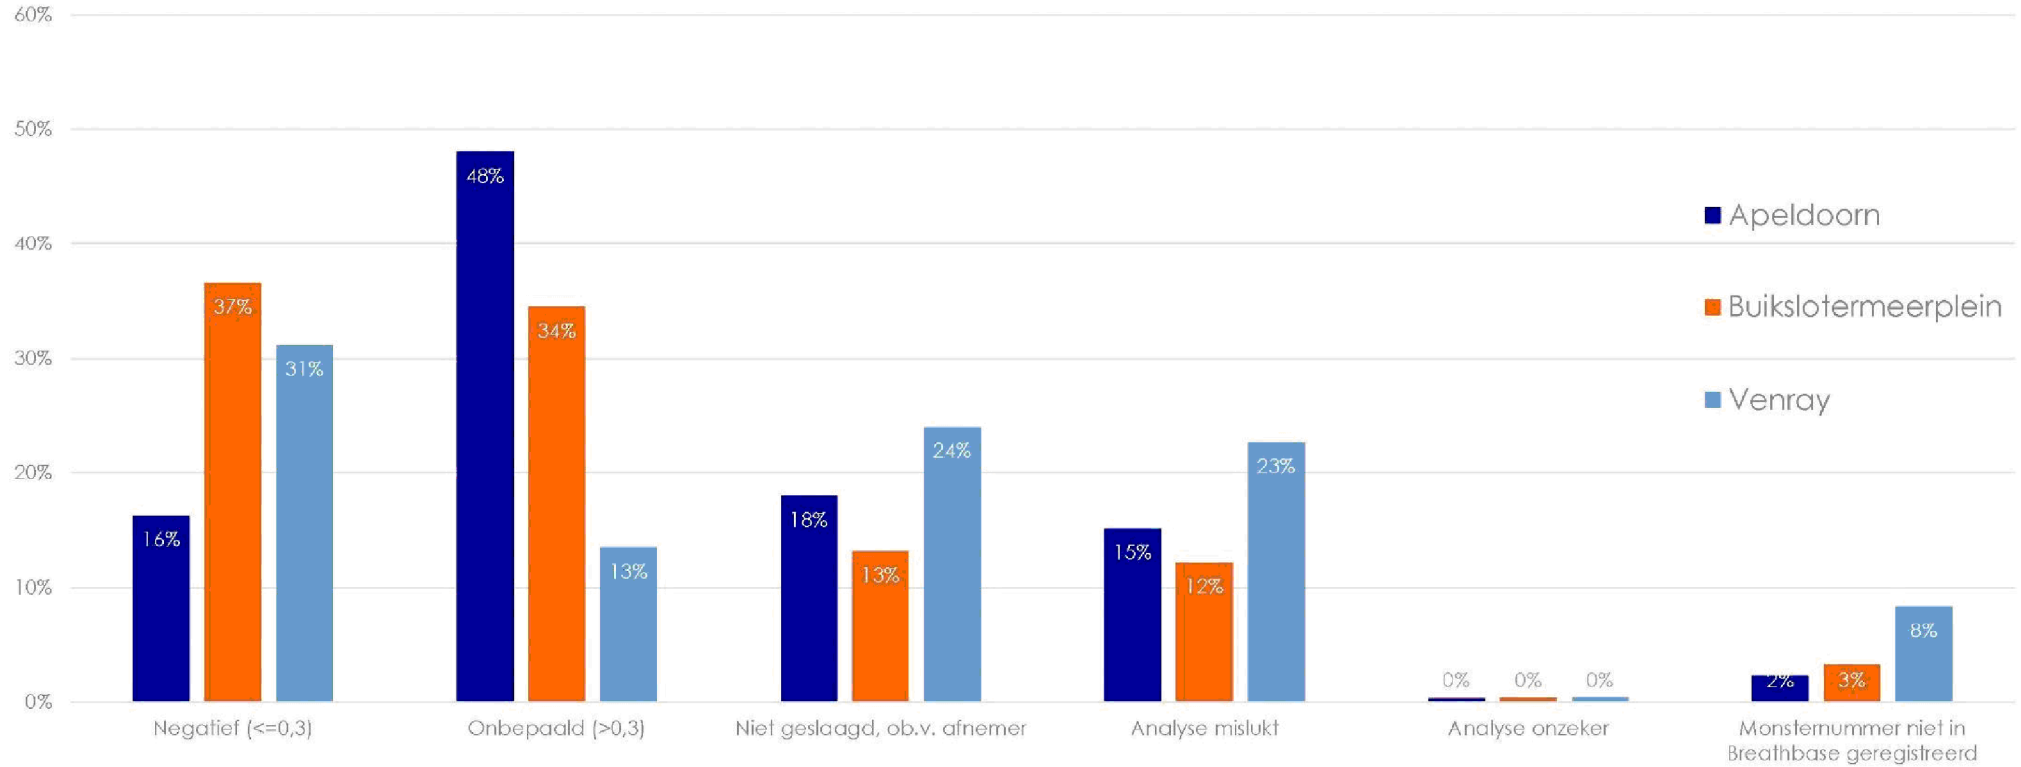

Overzicht Dubbeldraaien Apeldoorn

10/06/2021 – 24/06/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT		7		**7**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT		1		**1**
Niet geslaagd, o.b.v afnemer		64		**64**
Analyse onzeker		1		**1**
Analyse mislukt	1	53		**54**
Onbepaald (> 0,3)	2	163	6	**171**
Negatief (≤ 0,3)	1	56	1	**58**
Totaal	**4**	**345**	**7**	**356**

- Sensitiviteit 0,75 (3/4) Interval**: 0,19 ; 0,99
- Specificiteit 0,17 (57/345) Interval* : 0,13 ; 0,21
- PVW 0,01 (3/291) interval**: 0,00 ; 0,03
- NVW 0,98 (57/58) interval**: 0,91 ; 1,00

* Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Wison score interval (alpha = 0,05)

** Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Clopper Pearson exact binomial interval (alpha = 0,05)

Overzicht Dubbeldraaien Buikslotermeerplein

9/06/2021 – 24/06/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT	1	11		**12**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT	1***	6	1	**8**
Niet geslaagd, o.b.v afnemer	4	76	1	**81**
Analyse onzeker		2		**2**
Analyse mislukt	3	72		**75**
Onbepaald (> 0,3)	5	206	1	**212**
Negatief (≤ 0,3)	4	220	1	**225**
Totaal	**18**	**593**	**4**	**615**

- Sensitiviteit 0,72 (13/18) interval**: 0,47 ; 0,90
- Specificiteit 0,38 (226/593) interval* : 0,34 ; 0,42
- PVW 0,03(13/380) interval**: 0,02 ; 0,06
- NVW 0,98 (226/231) interval**: 0,95 ; 0,99

* Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Wilson score interval (alpha = 0,05) ** Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Clopper Pearson exact binomial interval (alpha = 0,05)
*** Mee gerekend bij fout negatieven.

Overzicht Dubbeldraaien Venray

9/06/2021 – 24/06/2021

CoronIT & Breathbase	PCR			
	Positief	Negatief	Onbeoordeelbaar	Totaal
Niet geregistreerd in BB, On-beoordeelbaar in CoronIT	1	29		**30**
Niet geregistreerd in BB, Negatief in CoronIT		12		**12**
Niet geslaagd, o.b.v afnemer	4	117		**121**
Analyse onzeker		2		**2**
Analyse mislukt	8	104	1	**113**
Onbepaald (> 0,3)	2	66		**68**
Negatief (≤ 0,3)	3	154	1	**158**
Totaal	**18**	**484**	**2**	**504**

- Sensitiviteit 0,59 (15/18) Interval** : 0,83 ; 0,96
- Specificiteit 0,34 (166/484) Interval* : 0,30 ; 0,39
- PVW 0,05 (15/333) interval* : 0,03 ; 0,07
- NVW 0,98 (166/169) interval** : 0,95 ; 1,00

* Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Wilson score interval (alpha = 0,05)

** Betrouwbaarheidsinterval berekend middels Clopper Pearson exact binomial interval (alpha = 0,05)

Opmerkingen

1. Van een aantal personen is de barcode niet ingescand in Breathbase. Hierdoor is de betreffende Breathbase uitslag niet te achterhalen. Op basis van de invoer in CoronIT is wel te achterhalen welke uitslag de cliënt (schriftelijk) heeft mee gekregen.

2. Bij verscheidene cliënten zijn na het afnemen van de ademtest afspraak meerdere PCR testen afgenomen. Deze cliënten worden als 1 afname meegenomen. De eerste niet "onbekende" uitslag is hierbij leidend.

3. Bij meerdere (21) cliënten is de uitslag van de ademtest als "onbekend" geregistreerd in CoronIT. Dit lijkt een registratiefout te zijn, die voordoet wanneer een afnemer de uitslag niet juist geregistreerd of niet de juiste rechten heeft om deze afname te kunnen registreren. Deze metingen worden op dit moment niet meegenomen in de rapportage, maar zullen worden toegevoegd wanneer de uitslag bekend is. In de verdiepende analyse zal hier verder op worden in gegaan.

Analyse Spironose ademtesten
Venray, Buikslotermeerplein, Apeldoorn

Cumulatieve rapportage platte data

Op basis van gegevens:

Venray, Buikslotermeerplein	09/06/2021 – 24/06/2021
Apeldoorn	10/06/2021 – 24/06/2021

GGD GHOR NEDERLAND